



発行番号XXXXXX号

発行日20YY年MM月DD日

校正証明書

依頼者XXXXXXXX

製造者(株)エー・アンド・デイ

校正日20YY年MM月DD日

校正結果別紙 検査成績書のとおり

備考なし

品名	型式	製造番号
デジタル膜厚計	AD-3256	XXXXXXX

上記製品は、別紙の検査成績書のとおり校正された事を証明致します。
尚、検査に使用した標準器は、国家標準もしくは国際標準にトレーサブルです。

使用標準器

標準器名	型式	識別記号	管理番号	有効期限
デジマイクロ	MH-15M	XXXXXX	L-312	20YY年MM月DD日
デジマイクロスタンド	MS-51C	XXXXXX	L-313	20YY年MM月DD日
以下余白				



検査成績書

発行番号 XXXXXX号

製品名	デジタル膜厚計	検査年月日	20YY年 MM月 DD日
型式	AD-3256	温湿度	23℃ 50%RH
製造番号	XXXXXXXX	検査場所	株式会社エー・アンド・デイ開発・技術センター
検査条件			
使用試験装置	標準器名	型式	管理番号
	デジマイクロ	MH-15M	L-312
	デジマイクロスタンド	MS-51C	L-313

○性能検査

磁性素地 (Fe)			
基準値 [μm]	標準フイル厚 [μm]	表示値 [μm]	許容範囲 [μm]
25.0	23.74	23.2	±5.8
125	124.30	125	±5
500	496.21	503	±16
1000	997.96	1016	±31

非磁性素地 (NFe)			
基準値 [μm]	標準フイル厚 [μm]	表示値 [μm]	許容範囲 [μm]
25.0	23.74	22.3	±5.8
125	124.30	123	±5
500	496.21	493	±16
1000	997.96	1001	±31

○機能検査


電源 On/Off	OK	ブザー音	OK
ランプ機能	OK	ボタン機能	OK
液晶表示	OK	画面回転機能	OK
オートパワーオフ	OK	PC接続機能	OK

総合判定

承認	検査

トレーサビリティ体系図（長さ関係）

標準器は下記の体系により国家標準にトレーサブルです

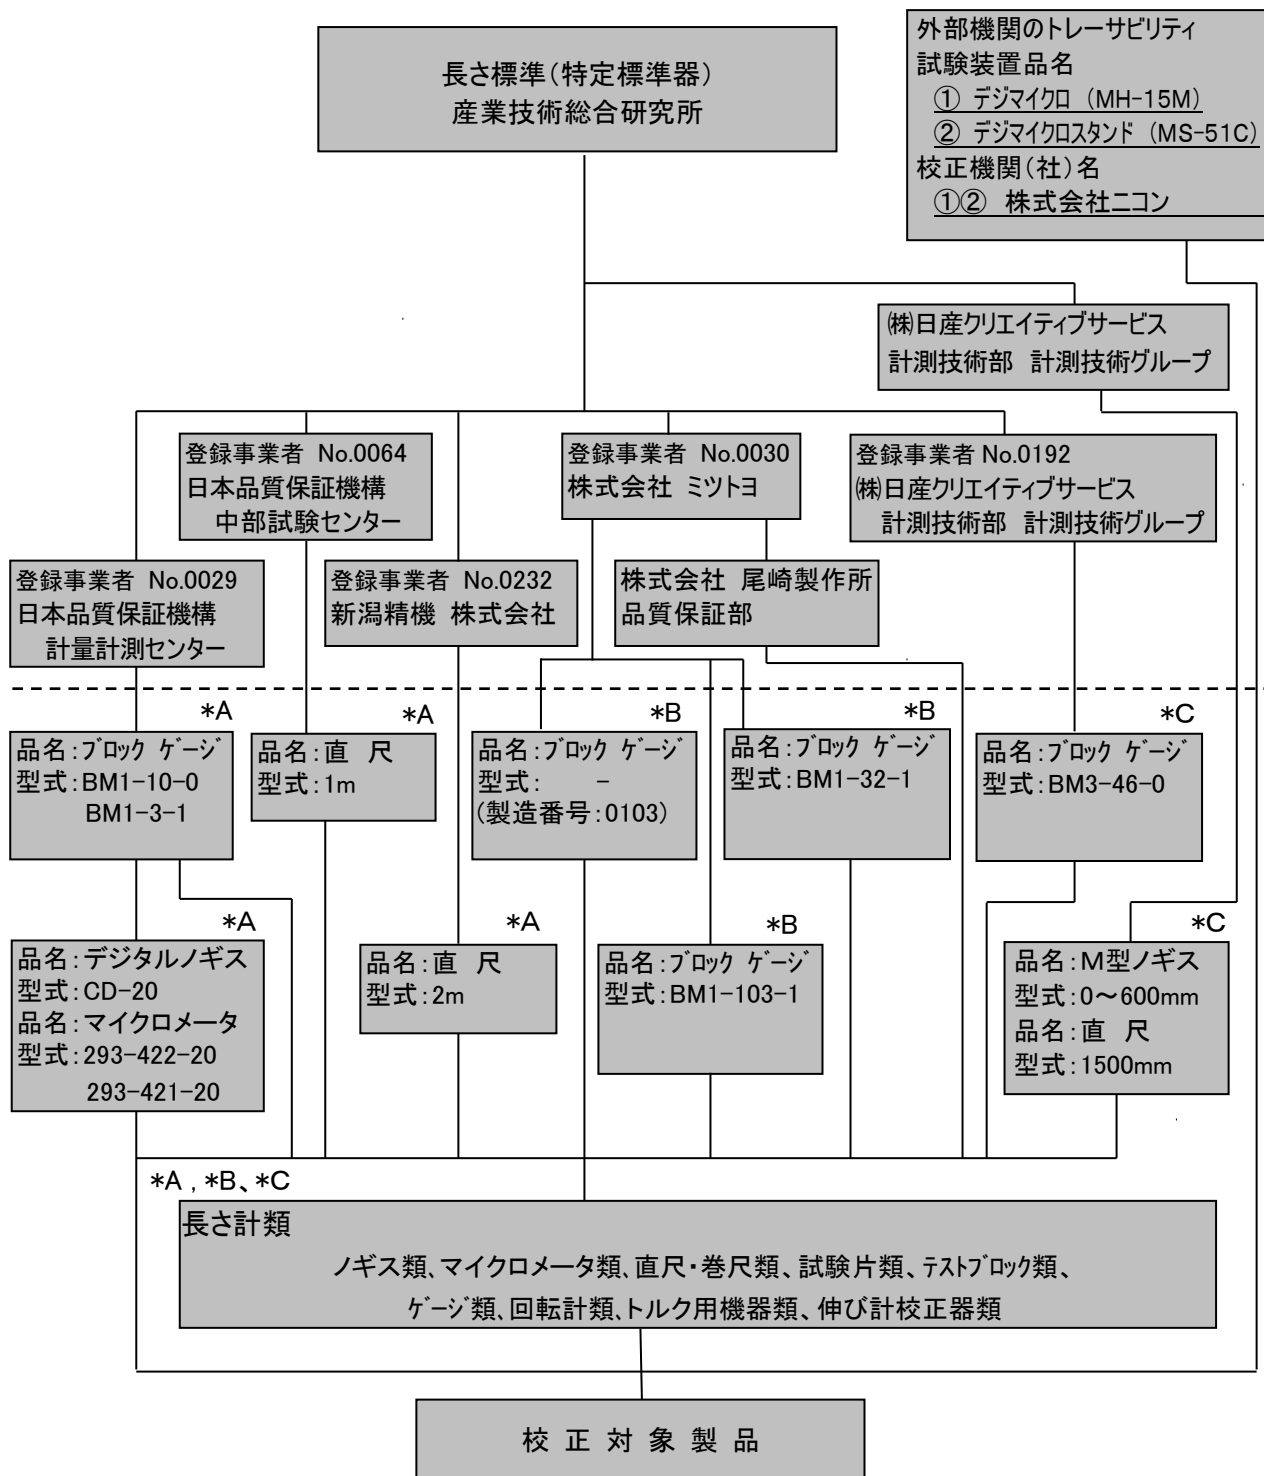

備考 標準器の所有者は図中下記の略号で表示

*A:(株)エーアンドデイ、*B:(株)A&Dマニュファクチャリング 深谷事業所、

*C:(株)A&Dマニュファクチャリング 日高事業所